

MANUAL DE INSTRUCCIONES

HALO2
HI9810312

Medidor de pH
inalámbrico para
cerveza



Foodcare

 **HANNA**
instruments®

**Estimado
cliente:**

Gracias por elegir un producto HANNA Instruments.
Lea atentamente este manual antes de utilizar este instrumento.
En él encontrará toda la información necesaria para utilizar el instrumento correctamente y hacerse una idea de su gran versatilidad.
Si necesita más información técnica, no dude en escribirnos a sat@hanna.es o visite nuestra página web www.hanna.es, donde encontrará nuestros datos de contacto.

ÍNDICE

1. Revisión previa	4
2. Especificaciones	4
3. Descripción general	5
Modo de funcionamiento	5
Características de la sonda	5
4. Descripción funcional y pantalla LCD	5
5. Operaciones básicas	6
Encendido y apagado del medidor	6
Cambio de la pila	6
6. Configuración	6
Unidades de temperatura	6
Intervalo de apagado automático	6
Puntos de calibración	6
Grupo de tampones	6
Resolución de pH	6
Modo Bluetooth®	6
Conexión Bluetooth	7
Fecha y hora	7
7. Bluetooth.....	7
8. Aplicación Hanna Lab	7
Nombrar una medida	7
9. Calibración.....	8
Preparación y recomendaciones	8
Procedimiento	8
Medidor independiente (calibración de hasta tres puntos)	8
Conectado a App Hanna Lab (calibración de hasta cuatro puntos)	8
10. Cuidado y mantenimiento	9
Almacenamiento	9
11. Mensajes de advertencia y error	9
12. Abreviaturas	9
13. Accesorios	10
Recomendaciones para los usuarios	10
Garantía	10
Certificación	11

1. REVISIÓN PREVIA

Extraiga el instrumento y los accesorios del embalaje y revíselos atentamente. Para recibir asistencia técnica, póngase en contacto con su oficina local de HANNA Instruments o escribanos un correo a sat@hanna.es.

Cada HI9810312 se entrega con un kit básico compuesto de:

- Solución tampón de pH 4,01, sobre de 20 ml (2 uds.)
- Solución tampón de pH 7,01, sobre de 20 ml (2 uds.)
- Solución de limpieza para depósitos de cerveza, sobre de 20 ml (2 ud.)
- Solución de almacenamiento de electrodos, pipeta cuentagotas de 13 ml (1 ud.)
- Solución recarga electrolito, 30 ml
- Pila de litio de 3V – CR2032
- Certificado de calidad del instrumento y Manual de instrucciones

Nota: Conserve todo el material de embalaje hasta estar seguro de que el instrumento funciona correctamente. Si encuentra algún artículo dañado o defectuoso, deberá devolverlo en su embalaje original con los accesorios incluidos.

2. ESPECIFICACIONES

Rango	pH	0,00 a 12,00 pH
	mV *	Modo pH/mV
	Temperatura **	Entre 0,0 y 80,0 °C
Resolución	pH	0,01 o 0,1 pH
	mV *	0,1 o 1 mV
	Temperatura	0,1 °C
Exactitud	pH	± 0,05 pH
	Temperatura	± 0,5 °C
Calibración	Hasta tres o cuatro puntos *	
	Reconocimiento automático del tampón con tampones estándar	
	Hanna (pH 1,68 *, 4,01, 7,01, 10,01) o NIST (pH 1,68 *, 4,01, 6,86, 9,18)	
Compensación de temperatura	Automática (ATC) o Manual (MTC) *	
Electrodo	Material del cuerpo	Titanio
	Vidrio	Baja temperatura (LT)
	Unión	Cerrada extraíble
	Célula de referencia	Doble, Ag/AgCl
	Electrolito	Gel
	Punta / Forma	Plana
	Diámetro exterior	12,7 mm
	Longitud	110 mm
Tipo de pila	Ion litio de 3V – CR2032	
Duración de la pila	Aproximadamente 1000 horas (500 horas con Bluetooth activado)	
Entorno	Entre 0 y 50 °C	
Carcasa	Índice de protección IP65	
Dimensiones	51 x 185 x 21 mm	
Peso	60 g	

* Disponible con App Hanna Lab

** Una medición fuera del rango de temperatura de funcionamiento recomendado puede dañar el gel de electrolito y anular la garantía del producto. Nota: El medidor puede mostrar mediciones entre -2,00 y 16,00 pH. Si la medición está fuera del rango de pH, parpadeará. En tal caso, compruebe la integridad del instrumento y revise el tipo de muestra medida.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL

HI9810312 es un medidor de pH profesional inalámbrico que forma parte de la familia HALO2 de Hanna Instruments.

- El módulo Bluetooth integrado permite conectar el medidor a un dispositivo inteligente móvil o tablet, compatible con la App Hanna Lab.
- El medidor incluye una carcasa compacta e impermeable y realiza una calibración de pH automática en hasta tres puntos, o cuatro puntos cuando se usa con la App Hanna Lab.
- Las lecturas de temperatura compensada automáticamente se muestran una gran pantalla LCD.
- El pH metro es preciso y fácil de usar. Ideal para las mediciones de pH durante el proceso de elaboración de la cerveza.

Modo de funcionamiento

El HI9810312 se puede usar como un medidor de pH independiente o conectado a la App Hanna Lab.

La App Hanna Lab convierte un dispositivo inteligente compatible en un medidor de pH completamente funcional. Las funciones incluyen: estado del electrodo, GLP con sello de tiempo, lecturas en continuo, visualización de mV, compensación manual de temperatura, criterios de estabilidad, recordatorio de calibración, alarmas de pH (mV) y temperatura, ID del medidor y envío de datos.

Características de la sonda

El cuerpo de titanio ofrece protección contra roturas accidentales. Robusto y resistente, el titanio funciona como un escudo electrónico que protege contra interferencias de ruido eléctrico o humedad.

La punta de vidrio plano permite la medición directa del pH y evita que se acumulen sólidos del mosto macerado y enfriado en la superficie que provocan una respuesta lenta y lecturas inestables.


La unión de tela extraíble permite eliminar cualquier obstrucción de sólidos que se acumulan en la superficie.

Tire 3 mm (1/8") para exponer una nueva superficie de unión fresca para tiempos de respuesta más rápidos y estabilidad en la lectura. El diseño de doble unión presenta una solución de electrolito sin plata que interacciona con la muestra, lo que hace que el electrodo sea menos susceptible a obstruirse y garantizando una respuesta rápida y una lectura estable.


El sensor de temperatura integrado en la punta del electrodo de pH permite determinar rápidamente la temperatura de la muestra y una lectura de temperatura de alta precisión.

4. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL Y PANTALLA LCD

Vista frontal y trasera

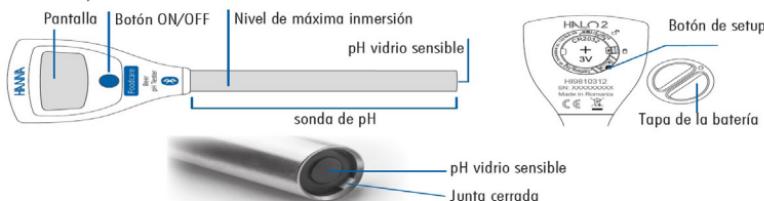

Pantalla LCD

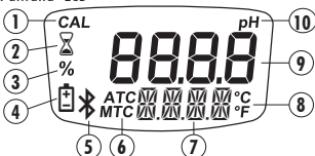

- | | | | |
|---|------------------------------------|----|-----------------------------|
| 1 | Indicador de calibración | 6 | Compensación de temperatura |
| 2 | Indicador de estabilidad | 7 | Segunda línea LCD |
| 3 | Indicador de porcentaje de batería | 8 | Unidad de temperatura |
| 4 | Icono de la batería | 9 | Primera línea LCD |
| 5 | Icono Bluetooth | 10 | Unidad de medida |

5. OPERACIONES BÁSICAS

Encendido y apagado del medidor

- Coloque el medidor boca abajo. Gire la tapa de la pila situada en la parte trasera del medidor en sentido contrario a las agujas del reloj y resérvela. Retire la lámina de aislamiento de la pila.
- Pulse el botón ON/OFF para encender o apagar el medidor. La pantalla de inicialización muestra todos los segmentos de la LCD, seguido del porcentaje de batería restante. El medidor accede al modo de medición. Antes de que el medidor se apague, se muestra brevemente "OFF PWR".
- Mantenga pulsado el botón ON/OFF para apagar el medidor cuando esté conectado a Bluetooth.

Pasador metálico

Cambio de la pila

1. Apague el medidor. Coloque el medidor boca abajo y gire la tapa de la pila en sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Reserve la tapa de la pila. Presione el pasador metálico para sacar la pila usada.
3. Inserte una pila nueva con el signo positivo (+) hacia arriba.
4. Vuelva a establecer la fecha y la hora en el modo de configuración o conéctese a la App Hanna Lab para actualizarla automáticamente.
5. Alinee la marca de la tapa con el ícono del candado abierto (🔓) en la carcasa. Gire la tapa en sentido de las agujas del reloj hasta la que la marca de la tapa quede alineada con el ícono del candado cerrado (🔒).

6. CONFIGURACIÓN

El botón de configuración está situado en el interior del compartimento de la pila. Tras finalizar la configuración, vuelve a colocar la tapa. Navegación en el menú de configuración

- Pulse el botón de configuración para acceder al modo de configuración y navegar por los elementos del menú.
- Para salir del modo de configuración, pulse el botón de configuración después de que se muestre la opción "SEt TIME".
- Pulse el botón ON/OFF para configurar las opciones de los elementos del menú.

Unidades de temperatura

Opciones: °C o °F

Pulse el botón ON/OFF para seleccionar la unidad de temperatura deseada.



Intervalo de apagado automático

Opciones: 8 min, 60 min o "----" (deshabilitado)

Pulse el botón ON/OFF para seleccionar el intervalo deseado.



Para aumentar la duración de la pila, una vez transcurrido el intervalo de apagado automático seleccionado, el medidor se apagará automáticamente.

Puntos de calibración

Opciones: 2P o 3P

Pulse el botón ON/OFF para elegir entre calibración de hasta dos o de hasta tres puntos.



Set de tampones

Opciones: pH 7,01 (Hanna) o pH 6,86 (NIST)

Pulse el botón ON/OFF para seleccionar el grupo de tampones de calibración (Hanna o NIST).



Resolución de pH

Opciones: 0,01 pH o 0,1 pH


Pulse el botón ON/OFF para seleccionar la resolución.



Modo inalámbrico Bluetooth

Opciones: On, PAIR u OFF

Pulse el botón ON/OFF para seleccionar la opción Bluetooth durante el arranque.

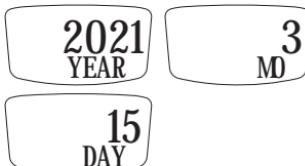

Conexión Bluetooth

Opción: dEL PAIR

Pulse el botón ON/OFF para eliminar el dispositivo emparejado guardado.

Fecha y hora

Opción: SET TIME

Pulse el botón ON/OFF para establecer la fecha y la hora.

Opciones: YEAR (año), MO (mes), DAY (día), HOUR (horas) y MIN (minutos)

Use el botón de configuración para seleccionar la opción y pulse el botón ON/OFF para cambiar el ajuste de la opción seleccionada.

7. BLUETOOTH

Con "PAIR BLU" o "On BLU" seleccionado en el modo de configuración, el icono Bluetooth (&) parpadeará durante hasta 45 segundos para indicar que el medidor está en modo de emparejamiento. Una vez conectado, el icono dejará de parpadear. Si no se conecta, el icono desaparecerá.

- Seleccione "On BLU" para habilitar Bluetooth sin vinculación.
- Seleccione "PAIR BLU" para habilitar Bluetooth con vinculación. La primera vez que el medidor se empareja con un dispositivo inteligente, se muestra un código de vinculación de 6 dígitos(pasan en scroll). Una vez emparejados los dispositivos, no es necesario volver a introducir el código para volver a conectarlos.
- Seleccione "OFF BLU" para deshabilitar Bluetooth.
- Seleccione "dEL PAIR" para eliminar todos los dispositivos emparejados. Si "PAIR BLU" está habilitado, será necesario introducir un código de vinculación para volver a acceder.

8. APPLICACIÓN HANNA LAB

- La App Hanna Lab está disponible en App Store® y en Google Play, de forma gratuita.
- Consulte la sección Ayuda de la aplicación para obtener información sobre calibración, medición, registro de datos e intercambio de datos.
- Si el medidor está en modo de emparejamiento, aparecerá en la lista "Dispositivos disponibles".
- En la aplicación, pulse "Conectar" para emparejar el medidor con el dispositivo. Todas las lecturas se transmitirán directamente a la aplicación.

Nombrar una medida

Tras conectar el medidor a la aplicación, se puede pulsar el botón ON/OFF para etiquetar la lectura actual.

- Pulse el botón ON/OFF en el modo de medición. La pantalla mostrará "SET TAG", seguido de "- TAG".
- En la aplicación, la lectura parpadeará en verde y se mostrará el icono de nota (○). Pulse sobre el icono de nota (○) para añadir un comentario.



9. CALIBRACIÓN

Preparación y recomendaciones

1. Saque la sonda del tapón de plástico de almacenamiento. Guarde el tapón para el almacenamiento de la sonda.
2. Elimine cualquier resto de solución de almacenamiento o de sales que puedan quedar en el cuerpo.
3. Compruebe que hay solución en el interior del bulbo de pH agitando la sonda para restablecer la continuidad, ya que la solución puede haberse desplazado hacia la varilla durante el envío.
4. Para obtener un resultado óptimo, use un vaso de enjuague y un vaso de calibración separado para cada tampón. Deseche los tampones de enjuague tras su uso.

Procedimiento

Para la mayoría de las aplicaciones, se recomienda comenzar con el tampón de pH 7,01 (o pH 6,86).

Para restablecer los ajustes de fábrica, mantenga pulsado el botón ON/OFF. Se muestra "CAL CLR".

Nota: Se recomienda calibrar el electrodo con los tampones a la misma temperatura a la que se vaya a usar para realizar las mediciones.

Medidor independiente (calibración de hasta tres puntos)

1. Enjuague la punta del electrodo con agua destilada y séquela (sin frotar) con papel secante. A continuación, enjuague con el tampón que vaya a usar para la calibración.
2. Mantenga pulsado el botón ON/OFF hasta que se muestre "CAL MODE".
3. Cuando se muestre "7.01 USE" o "6.86 USE" con la palabra "CAL" parpadeando, introduzca la punta del electrodo en el tampón correcto.



4. Cuando el tampón se reconoce, se muestra "REC".

A continuación, se muestra "WAIT" (Esperar) con el indicador de estabilidad (#) parpadeando hasta que la lectura de estabilizó.

Espere hasta que se guarde la medición y desaparezca el indicador de estabilidad.



5. Si desea guardar una calibración de un punto y volver al modo de medición, pulse el botón ON/OFF.

Se mostrará "CAL SAVE" brevemente.

Si se ha seleccionado la opción 2P

6. Introduzca la punta del electrodo en el segundo vaso de enjuague con tampón y, a continuación, en el segundo tampón de calibración. Espere hasta que se guarde la medición y desaparezca el indicador de estabilidad.
7. Despues de que se haya guardado el segundo punto, se muestra "CAL SAVE" brevemente y el medidor vuelve automáticamente al modo de medición.

Si se ha seleccionado la opción 3P

6. Introduzca la punta del electrodo en el segundo vaso de enjuague con tampón y, a continuación, en el segundo tampón de calibración. Espere hasta que se guarde la medición y desaparezca el indicador de estabilidad.
7. Introduzca la punta del electrodo en el tercer vaso de enjuague con tampón y, a continuación, en el tercer tampón de calibración. Espere hasta que se guarde la medición y desaparezca el indicador de estabilidad.
8. Despues de que se haya guardado el tercer punto, se muestra "CAL SAVE" brevemente y el medidor vuelve automáticamente al modo de medición.

Conectado a App Hanna Lab (calibración de hasta cuatro puntos)

Conecte el medidor a la App Hanna Lab y siga el procedimiento de calibración.

Consulte la sección "Ayuda" de la App para conocer el procedimiento de calibración.

10. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Nunca sumerja el medidor superando el nivel de inmersión máximo.
- Conviene utilizar tampones nuevos para cada calibración. Una vez abiertos los sobres, el valor del tampón puede variar con el paso del tiempo.
- Si la respuesta del electrodo es lenta, sumérjalo en solución de limpieza durante 20 minutos. Enjuáguelo con agua e hidrátelo en solución de almacenamiento durante al menos 30 minutos antes de la calibración.
- Si piensa tomar varias mediciones seguidas en distintas muestras, enjuague bien la sonda en agua destilada o desionizada para evitar la contaminación cruzada entre mediciones.

Almacenamiento

Para garantizar una respuesta rápida del electrodo, la punta de vidrio y la unión deben mantenerse hidratadas.

Cuando no lo utilice, añada unas gotas de solución de almacenamiento en el tapón de almacenamiento. Si no dispone de solución de almacenamiento, puede usar solución tampón de pH 4,01 o pH 7,01.

Nota: No almaceñe el electrodo en agua destilada o desionizada.

11. MENSAJES DE ADVERTENCIA Y ERROR

WRNG

Se muestra "---- WRNG" durante a calibración.
El tampón no es válido.
Compruebe el valor del tampón y use tampón nuevo.

 **12.02**
ATC  **23.7°C**

El valor medido parpadea.
El valor medido está fuera del rango del electrodo.
Limpie el electrodo para mejorar su estado.

 **8.02**
ATC  **23.7°C**

El icono de la batería (!) parpadea.
Queda menos del 10 % de batería, sustituya la pila.

**BATT
DEAD**

Se muestra "BATT DEAD" y el medidor se apaga.
La pila se ha agotada, sustituya la pila.

12. ABREVIATURAS

ATC	Compensación automática de temperatura
GLP	Buenas prácticas de laboratorio
MTC	Compensación manual de temperatura
NIST	National Institute of Standards and Technology (Instituto nacional de normalización y tecnología)

13. ACCESORIOS

Información de pedido Descripción del producto

Solución tampón de pH

HI50016-02	Solución tampón de pH 1,68, sobres de 20 ml (25 uds)
HI70004P	Solución tampón de pH 4,01, sobres de 20 ml (25 uds)
HI70006P	Solución tampón de pH 6,86, sobres de 20 ml (25 uds)
HI70007P	Solución tampón de pH 7,01, sobres de 20 ml (25 uds)
HI70009P	Solución tampón de pH 9,18, sobres de 20 ml (25 uds)
HI70010P	Solución tampón de pH 10,01, sobres de 20 ml (25 uds)
HI77400P	Solución tampón de pH 4,01 y 7,01, sobres de 20 ml (10 uds cada uno)
HI770710P	Solución tampón de pH 10,01 y 7,01, sobres de 20 ml (10 uds cada uno)

Solución de limpieza de electrodos

HI700601P	Solución de limpieza de electrodos para uso general, sobres de 20 ml (25 uds)
HI7073L	Solución de limpieza para proteína, 500 ml
HI7074L	Solución de limpieza para soluciones inorgánicas, 500 ml
HI7077L	Solución de limpieza para aceites y ácidos grasos, 500 ml

Solución de almacenamiento de electrodos

HI70300L	Solución de almacenamiento de electrodos, 500 ml
HI70300M	Solución de almacenamiento de electrodos, 230 ml
HI70300S	Solución de almacenamiento de electrodos, 30 ml
HI9072	Solución de almacenamiento de electrodos, pipeta cuentagotas de 13 ml

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS

Antes de utilizar este producto, asegúrese de que es completamente apto para su aplicación específica y para el entorno donde pienso utilizarlo. Cualquier cambio que el usuario haga en el equipo suministrado puede deteriorar el rendimiento del medidor. Por su seguridad y la del medidor, no lo utilice ni almacene en entornos peligrosos.

GARANTÍA

El **HI9810312** cuenta con un año de garantía que cubre los defectos de mano de obra y materiales, siempre que se utilice para los fines previstos y se mantenga según las instrucciones. La garantía se limita a una reparación o sustitución gratuitos. No cubre los daños provocados por accidentes, usos y manipulaciones indebidos ni por la omisión del mantenimiento obligatorio. Si necesita mantenimiento, póngase en contacto con su oficina local de HANNA Instruments. Si el instrumento está en garantía, indique el número de modelo, la fecha de compra, el número de serie y el tipo de problema. Si la reparación no está cubierta por la garantía, se le informará de los gastos incurridos. Para devolver el medidor a HANNA Instruments, debe obtener primero un número de Autorización para la Devolución de Productos (RGA) del departamento de servicio técnico; después envíelo con los gastos de envío pagados. Cuando vaya a enviar cualquier producto, asegúrese de enviarlo conforme a normativa de transporte aplicable, perfectamente limpio y sin productos químicos y de empaquetarlo bien para protegerlo debidamente.

CERTIFICACIÓN

Todos los productos de HANNA Instruments cumplen las Directivas europeas CE.

Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos. El producto no se debe tratar como basura doméstica. Se debe entregar en el punto de recogida apropiado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos, lo cual ayudará a la conservación de los recursos naturales.

Eliminación de pilas usadas. Este producto contiene pilas, no las deseche con otros residuos domésticos. Entréguelas en el punto de recolección apropiado para su reciclaje. Al garantizar la eliminación adecuada del producto y de las pilas, se evitan las consecuencias negativas potenciales para el medioambiente y la salud humana. Para más información, póngase en contacto con su ciudad, su servicio local de eliminación de residuos domésticos o el lugar de compra.

Avisos legales para módulos Bluetooth independientes de bajo consumo

Todos los módulos tienen un funcionamiento idéntico. Todas las referencias a las normas FCC estadounidenses y a las normas RSS canadienses sobre clasificación y funcionamiento de dispositivos, enumeradas en el Módulo BMD-300, son aplicables a todos los modelos aquí mencionados. Retire la tapa de la pila para comprobar el módulo instalado.

Módulo BMD-300

EE. UU. (FCC) FCC ID: 2AA9B04

Este dispositivo cumple con las reglas FCC parte 15, subparte C "Radiadores intencionales" y subparte B, apartado §15.105. Este equipo ha sido comprobado y cumple los límites de los dispositivos digitales de Clase A, de acuerdo con la parte 15 de las normas FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales al operar el equipo en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, podrían producirse interferencias en la recepción de señales de radio y televisión. Es muy probable que el uso de estos equipos en áreas residenciales cause interferencias, que tendrían que ser corregidas por el usuario por su propia cuenta.

Canadá (ISED) IC: 12208A-04

Este dispositivo cumple las normas RSS para equipos de radio exentos de licencia del Dpto. de Industria de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede producir interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que pueden afectar al funcionamiento del mismo. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Australia / Nueva Zelanda (RCM) BMD-300 cumple con la norma AS/NZS 4268.2017.

Japón (MIC)  [R]210-106799	Corea del Sur (KCC)  R-CRM-Rgd-BMD-300
Brasil (ANATEL): contiene el módulo aprobado por ANATEL # 00820-21-05903.	México (IFETEL): Este equipo contiene el módulo con IFT #: NYCE/CT/0146/17/TS.

Módulo BMD-350	
EE. UU. (FCC) FCC ID: 2AA9B05	Canadá (ISED) IC: 12208A-05
Japón (MIC)  [R]210-108944	Australia / Nueva Zelanda (RCM) BMD-350 cumple con la norma AS/NZS 4268.2017
Eurasia (EAC)  EA[EU]C N RU D-US.HA27.B.00650/18	Brasil (ANATEL) Confíe el módulo aprobado por ANATEL # 00857-21-05903
China (SRRC) CMIIT ID: 2018DJ7255	México (IFETEL) Este equipo contiene el módulo con IFT #: RCPRIIBM18-1491

Módulo ANNA-B112	
EE. UU. (FCC) FCC ID: XPYANNAB1	Canadá (ISED) IC: 8595A-ANNAB1
Taiwán (NCC) 内含發射器模組:  CCA118LP2200T2	Corea del Sur (KCC)  R-C-ULX-ANNA-B112
Sudáfrica (ICASA) ICASA TA-2019/1203 aprobado	China (SRRC) CMIIT ID: 2021DJ6698
Australia / Nueva Zelanda (ACMA) ANNA-B1 cumple con la norma AS/NZS 4268.2012	
Japón (MIC)  [R]204-810005	El módulo cumple con la certificación de la conformidad de los reglamentos técnicos de equipos radioeléctricos especificados (ordenanza de MPT N°. 37, 1981), artículo 2, párrafo 1, punto 19 "sistema de comunicación de datos de baja potencia de banda ancha con una banda de 2,4 GHz".
 00850-19-05903	Brasil (ANATEL) Este equipo opera a título secundario y, en consecuencia, debe aceptar las interferencias dañinas, incluidos las procedentes de estaciones de la misma clase, y no debe provocar interferencias dañinas en sistemas que operen a título primario.



RoHS
compliant



HANNA ESPAÑA

Hanna Instruments S.L.
Pol. Industrial Azitain parcela 3D
20600 EIBAR
GIPUZKOA 943820100
www.hanna.es

